

Kraków, 01.12.2023 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ
08.12.2023 ROKU**

dot. sprawy: 88/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy obłożeń operacyjnych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pytania do Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 13, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi wykonanymi z oddychającej membrany poliuretanowej o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymagań Zamawiającego tj. poz. 1: 40x27cm, poz. 2: 50x40cm, poz. 3: 68x80cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m²?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Pakiet 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x180cm zamiast 170 x 175-200cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Pakiet 1, 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami włókninowymi (włóknina spunlace o podwyższonej chłonności)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170x240cm zamiast 150x240cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x180cm zamiast 170x175-200cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8

Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m²?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9

Pakiet 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.
- 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.
- 1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,
- 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 2 x ręczniki chłonne Spunlace 30cm x 30cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10

Pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11

Pakiet 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12

Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 170x240cm zamiast 170x300cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13

Pakiet 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno zapakowaną serwetą 150x210cm, zamiast 150x200cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14

Pakiet 5 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów (zamiast uchwytem typu rzep)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15

Pakiet 5 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x300cm z samouszczelniającym się otworem, zamiast rozmiaru 220x320cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16

Pakiet 5 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x180cm zamiast 150x175cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17

Pakiet 5 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno zapakowaną osłoną na kończynę w rozmiarze 30x80cm, do osłony dołączona jest taśma przylepna?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18

Pakiet 5 poz.1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami włókninowymi (włóknina spunlace o podwyższonej chłonności)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19

Pakiet 5 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20

Pakiet 5 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x300cm z samouszczelniającym się otworem, zamiast rozmiaru 245x320cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21

Pakiet 5 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x180cm zamiast 100x150cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22

Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23

Pakiet 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczy 6 cm, zintegrowana z bezłateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24

Pakiet 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25

Pakiet 8 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26

Pakiet 8 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 27

Pakiet 8 poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej w rozmiarze 30x40cm (15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m²? Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29

Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 30cm x 60cm w zestawie z taśmą samoprzylepną 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30

Pakiet 11 – Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na podłokietnik o wymiarach 35cm x 75cm wykonanych z dwuwarstwowego laminatu? Osłony posiadają dodatkowo taśmę samoprzylepną.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31

Pakiet 14 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni całkowitej 30x26cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 32

Pakiet 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów 2 warstwowych tj. papier 23g/m², folia 17g/m²?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 33

Pakiet 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu. op. 56 szt. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny o gramaturze 125g /m². Waga produktu 120g?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34

Pakiet 15, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwale zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt., Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 35

Pakiet 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z trzywarstwowego laminatu (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 50x75cm z samoprzylepnym otworem Ø 7cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36

Pakiet 16, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z trzywarstwowego laminatu (włóknina + folia PE + włóknina) o wymiarach 90x120cm z samoprzylepnym otworem Ø 10cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37

Pakiet 17, 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z trzywarstwowego laminatu (włóknina + folia PE + włóknina)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z uwzględnieniem zachowania rozmiarów podanych w SWZ.

Pytanie 38

Pakiet 18 poz.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety trzywarstwowej o chłonności 383% zamiast serwety z latą chłonną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z uwzględnieniem zachowania rozmiarów podanych w SWZ.


Pytanie 39

Pakiet 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 45g/m² 50cm x 60cm
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 45g/m² 50cm x 60cm, z centralnym otworem o średnicy 5 cm i przecięciem
- 2 szt. Rękawice diagn. nitylowe bezpudrowe rozm. M w opakowaniu papierowym
- 6 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20 cm x 20 cm, 17-nitkowy
- 8 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm, 17-nitkowy, 8-warstwowy
- 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony
- 1 szt. Chwytnik plastikowy Pean dł. 14cm; polipropylen; kolor niebieski
- 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml; polipropylen; kolor transparentny

Osobno zapakowane

- 1 szt. Ampulostrzykawką z wodą sterylną z 10% roztworem gliceryny
- 1 szt. Ampulostrzykawką wypełnioną lubrykantem

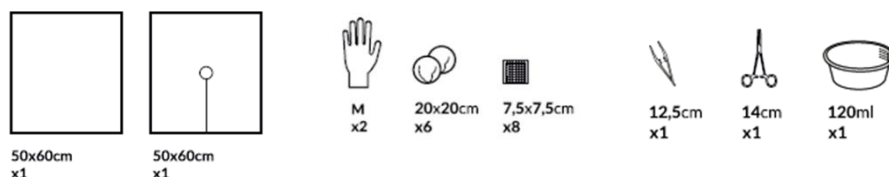


Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że zestaw zawiera lubrykant z lidokainą.

Pytanie 40

Pakiet 21 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 90cm x 75cm
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 45cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm
- 10 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa
- 10 szt. Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17-nitkowa, 8-warstwowa
- 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski
- 1 szt. Chwytnik metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 10ml, Luer
- 1 szt. Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia poj. 20ml, Luer
- 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm
- 1 szt. Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 0,8mm x 40mm
- 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1 szt. Opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu w opakowaniu papier-folia 10cm x 15cm

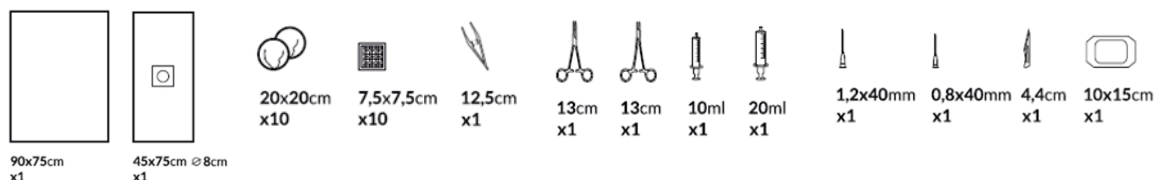

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41

Pakiet 24, 25, 26 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 42

Pakiet 24 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml 2-częściową przezroczystą z białym tłokiem w miejsce strzykawki 20 ml Luer 2 częściowa niebieska?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 43

Pakiet 24 poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna do kraniotomii 230x300 2-warstwowa wzmocn, otwór z folią 24x34, torba
- 4 szt. Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa, z przylepcem
- 2 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1 szt. Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna
- 1 szt. Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 25cm, samoprzylepna
- 1 szt. Serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm wzmocniona (145cm x 60cm), niebieska
- 2 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1 szt. Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm
- 2 szt. Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. XL
- 1 szt. Dren do odsysania pola operacyjnego (dl.300cm CH30, lejek-lejek)
- 1 szt. Końcówka do odsysania bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH 23, 4 otw boczne)
- 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 500ml, niebieski, z podziałką
- 1 szt. Czyścidelko do elektrod 50mm x 50mm
- 2 szt. Strzykawka 2-częściowa 20 ml Luer
- 40 szt. Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG
- 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 10
- 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11
- 2 szt. Serweta oper. z gazy 20N 4W 45cm x 45cm, znacz. RTG i tasiemka, wstępnie prana
- 1 szt. Pokrowiec na uchwyt lamp operacyjnych, elastyczny
- 1 szt. Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochir. metalowa, CH 9, dl. 160mm

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 44

Pakiet 24 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem o wymiarach 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 45

Pakiet 24 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z padem chłonnym o wymiarach 180cm x 180cm (zamiast 175x170cm)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46

Pakiet 24 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu Velcro o wymiarach 2cm x 22cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 47

Pakiet 24 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik o wymiarach 30cm x 30 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 48

Pakiet 24 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego metalowa CH 9 długość 16 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 49

Pakiet 24 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści dren CH 30 o długości 300cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 50

Pakiet 25 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem „U” dwuwarstwową (chłonna włóknina PP + nieprzemakalna folia PE) wzmocnioną padem chłonnym w obszarze krytycznym 230cm x 260cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 51

Pakiet 25 – Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną trójwarstwową (polietylen jako warstwa środkowa) 160cm x 220cm – w zamian serwety przylepnej 170 x 254 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 52

Pakiet 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 3 szt. Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm
- 1 szt. Serweta na stolik Mayo 140cm x 80cm wzmocniona, czerwona
- 1 szt. Serweta chirurgiczna ortopedyczna 230x260 wzmocniona, przylepne wycięcie U 20x100
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 160cm x 220cm 3-warstwowa, z przylepcem
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 150cm x 180cm 2-warstwowa
- 1 szt. Torebka na płyny 30cm x 40cm lub na narzędzia chirurgiczne, jednokomorowa
- 4 szt. Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. XL
- 10 szt. Serweta operacyjna z gazy 20N 4W 45cm x 45cm, znacz. RTG i tasiemka, wstępnie prana
- 80 szt. Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG (8x 10)
- 1 szt. Pojemnik okrągły poj. 500ml, niebieski, z podziałką
- 1 szt. Czyścidelko do elektrod 50mm x 50mm
- 1 szt. Tacka na skalpele
- 2 szt. Opaska elastyczna z zapinką 15cm x 5m, podtrzymująca, tkana
- 1 szt. Strzykawka 3-częściowa 100ml cewnikowa
- 2 szt. Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna
- 4 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1 szt. Oslona na kończynę 30cm x 80cm
- 1 szt. Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna
- 1 szt. Dren do odsysania pola operacyjnego (dl.300cm CH30, lejek-lejek)
- 1 szt. Końcówka do odsysania bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH 23, 4 otw boczne)
- 6 szt. Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1 szt. Licznik igieł na 20 szt., z magnesem i pianką, z usuwaczem ostrzy, czerwony
- 1 szt. Folia operacyjna 56cm x 84cm (56cm x 78cm)

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 53

Pakiet 26 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji kończyny dolnej z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, z wbudowanymi organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 54

Pakiet 26 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną o wymiarach 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 55

Pakiet 26 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści chustę z gazy 20-nitkową, 4-warstwową o wymiarach 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 56

Pakiet 26 poz.1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 57

Pakiet 26 poz.1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep o wymiarach 2cm x 22cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 58

Pakiet 26 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep o wymiarach 2cm x 22cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 59

Pakiet 26 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji dłoni/stopy o wymiarach 230cm x 300 cm, dwuwarstwową z otworem o średnicy 3,5cm oraz padem wzmocnieniem wokół otworu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 60

Pakiet 26 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści chustę z gazy 20-nitkowe, 4-warstwowe po wstępnym praniu o wymiarach 45cm x 45cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 61

Pakiet 26 poz.3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji ręki prostokątną o wymiarach 230 cm x 300 cm, 2 warstwową z otworem o średnicy 3,5 cm, z wzmocnieniem wokół otworu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 62

Pakiet 26 poz.3 – Czy Zamawiający dopuści tupfer typu fasolka o wymiarach 15 cm x 15 cm zapakowany w torebce papierowej (zamiast pudełeczka)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 63

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylą, jednorazową osłonę na kamerę posiadającą karton ułatwiający zakładanie. Wymiar 13cm x 244cm,. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą.

Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazową osłonę na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 76 cm (+/- 3 cm) i szerokości 33 cm (+/-3 cm). Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. Ilpość w opakowaniu 150 szt.?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylą, jednorazową osłonę na sprzęt medyczny, szytą na okrągło, ściągniętą elastyczną gumką. Wykonana z polietylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nie zawiera lateksu. Rozmiar 152/76cm.?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanianość (badanie z wykorzystaniem wody) co najmniej 5600 g/m² potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Chłonność wg WSP 010.1.R3 and ISO9073-6 soli fizjologicznej 2,85l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485. Opakowanie 42 szt.?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 67

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7 mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1 cm) x 228 cm (+/- 1 cm). Produkt o gładkiej, jednolitej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość (badanie z wykorzystaniem wody) min. 3200 g/m² potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Chłonność wg WSP 010.1.R3 and ISO9073-6 soli fizjologicznej 2,25l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu. Oznaczony nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125 g/m² (+/-1%). Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9 s wg 16 CFR1610 klasa I. Ilość w opakowaniu 50 szt.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 68

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu osłonę na mikroskop Zeiss nie wyposażoną w chip elektroniczny? Biorąc pod uwagę fakt, że w praktyce taka nakładka z chipem elektrycznym nie wpływa na główne funkcje osłony, takie jak sterylność, przezroczystość, łatwość obsługi, a sprawia, że osłona jest co najmniej 2 razy droższa niż bez chipa. Pragniemy nadmienić, że opisana osłona dostępna jest tylko u jednego producenta.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 69Pytanie 1 – Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu posiadającego 2 ręczniki celulozowe, pozostały minimalny skład zgodny?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 70


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek pakietów nr 1;7;11;16;17;18 do dnia 08-12-2023 do godz.14 ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert wraz z próbkami do dn. 08.12.2023 roku do godz. 08:00. (patrz zmodyfikowany SWZ w tym zakresie).

Pytanie 71

Pakiet 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

skład	ilość	rozmiar
serweta z przylepcem L3	1	240x150
serweta z przylepcem L3	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku L3	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki z włókniny kompresowej do rąk	4	40x20

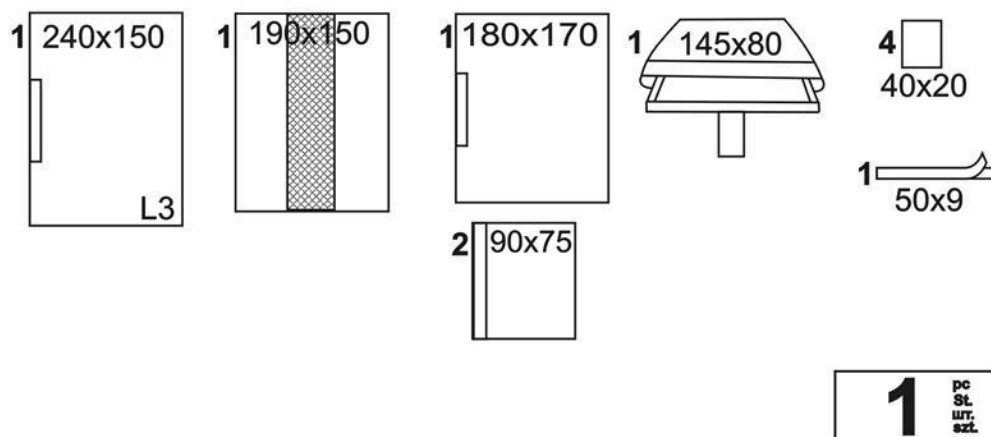


Odpowiedź: Nie.

Pytanie 72

Pakiet 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie

Serweta wzmocniona z przylepcem L2	1	240x150 (37,5x70)
Serweta wzmocniona z przylepcem L2	1	200x170 (37,5x70)
Serweta wzmocniona z przylepcem L2 - przylepiec na szerszym boku	2	90x75 (37,5x70)
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk włókninowe	2	40x20

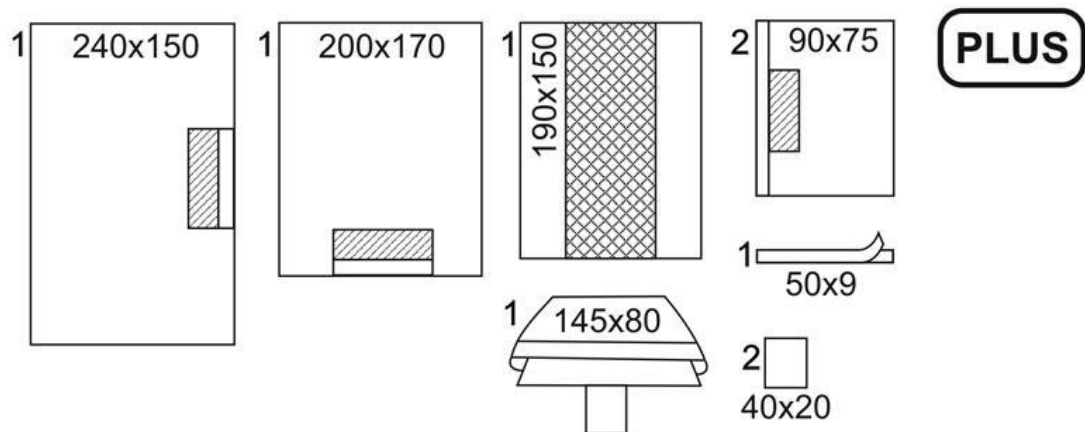


Odpowiedź: Nie.

Pytanie 73

Pakiet 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis składnika	Jednostka	Ilość
POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 120X37CM	SZ	1
SERWETA L3 260X200CM WYC U (100X7) PRZYL	SZ	1
SERWETA L3 240X150CM PRZYL	SZ	1
SERWETA L3 90X75CM PRZYL	SZ	1
SERWETA L3 180X150CM PRZYL 80 CM	SZ	1
SERWETA L3 300X180CM PRZYL 180 CM	SZ	1
SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	SZ	4
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM	SZ	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	SZ	1

TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL	SZ	2
-----------------------------------	----	---

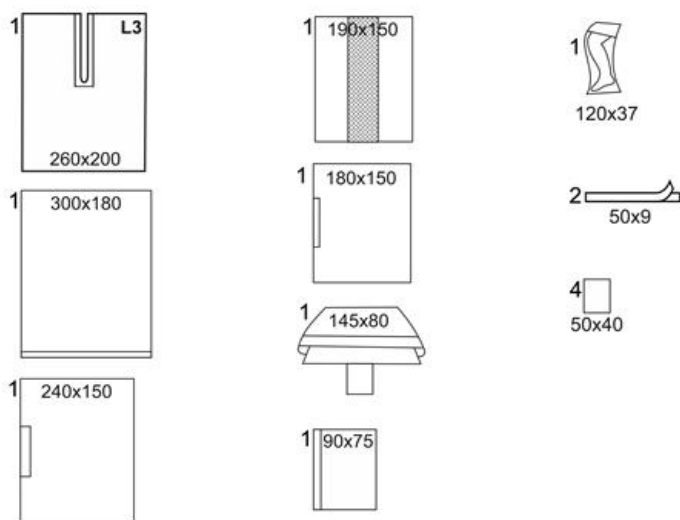


Odpowiedź: Tak.

Pytanie 74

Pakiet 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis składnika	Jednostka	Ilość
SERWETA L2 240X180CM OO15X10 PRZYL	SZ	1
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	SZ	1
SERWETA L2 180X150CM	SZ	1



Odpowiedź: Nie.

Pytanie 75

Pakiet 8, poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na kończyne z taśmą samoprzylepną 9x50 cm w rozmiarze 80x30cm ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 76

Pakiet 8, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kieszeń jednokomorową z kształtką i przylepcem w rozmiarze 40x30cm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 77

Pakiet 8, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kieszeń dwukomorową z kształtką i przylepcem w rozmiarze 42x35 cm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 78

Pakiet 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę lepłą w rozmiarze 9x50cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 79

Pakiet 12, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze (55÷162)x81cm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 80

Pakiet 12, poz.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę medyczną mocującą w rozmiarze 25x2cm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 81

Pakiet 16, poz.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze 75cmx45cm z otworem przylepnym, okrągłym, o średnicy 8 cm ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 82

Pakiet 16, poz.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze 150cmx90cm z otworem przylepnym, okrągłym, o średnicy 8 cm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 83

Pakiet 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, w którym „1szt pean plastikowy ok 14cm” zostanie zastąpiony przez 1szt pean plastikowy ok 13 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 84

Pakiet 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw w którym w miejscu „1szt igła 0,6x30mm” znajduje się 1 szt igła 0,5x25mm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 85

Pakiet 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana rewersowo

2 x serweta boczna 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna


1 x serweta dolna 195x 200 cm, przylepna

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, z zaokrągloną końcówką ułatwiająca rozdzielanie, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 13 -14cm

4 x ręcznik chłonny z mikro siecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 20x30

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepyłącego(współczynnik pylenia $\leq 1,9$ log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m² bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepłą serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepłą do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

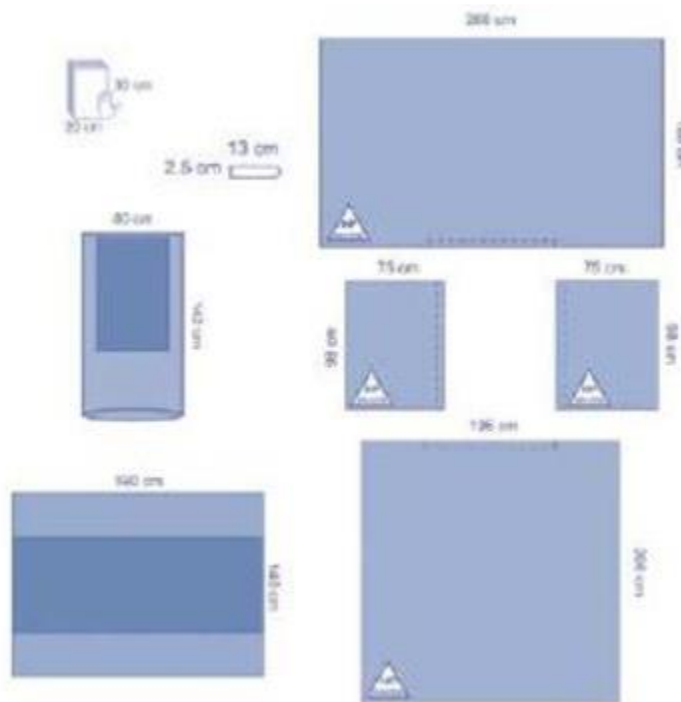

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 86

Pakiet 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna (taśma lepna dl. ok 80 cm)

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dl. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całą powierzchnię laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 87

Pakiet 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:

2x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ m ze wzmocnieniem

1x serweta ortopedyczna na stół Mayo 80x145 cm z folii PE 70 μ , ze wzmocnieniem 100x75cm,

1x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym

77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna zabezpieczona trzema taśmami, które ułatwiają precyzyjną aplikację serwety łącznie z zaokrągleniami wycięcia U, 1x serweta górną 183x254 cm przylepna, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów


1x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa

1x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwową, antypoślizgową

2x taśma przylepna 9x50 cm

2x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m², pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku $\leq 1,9 \log_{10}$, o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H₂O. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 140 g/m²) o odporności na przenikanie płynów > 200 cm H₂O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho > 570kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

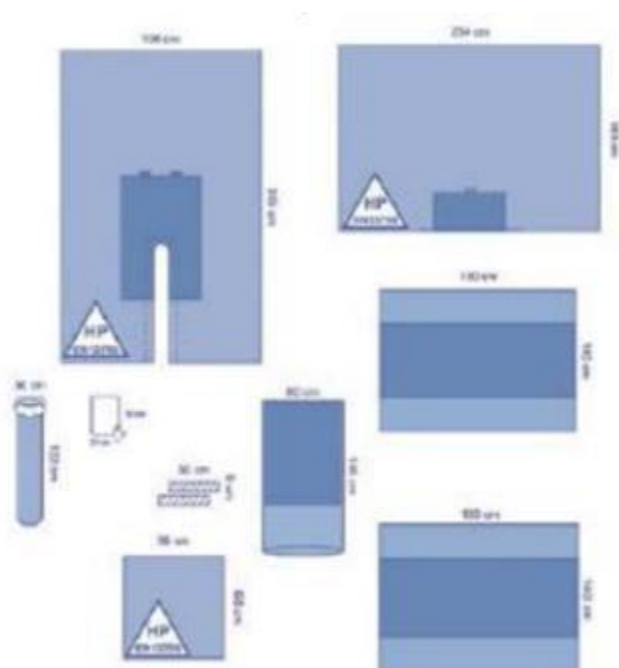

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 88

Pakiet 6


Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzylepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzuszny $\varnothing$ 8 cm, z przylepnym otworem na pręcie $\varnothing$ 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepłą do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m² pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$ i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H₂O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylizuje w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

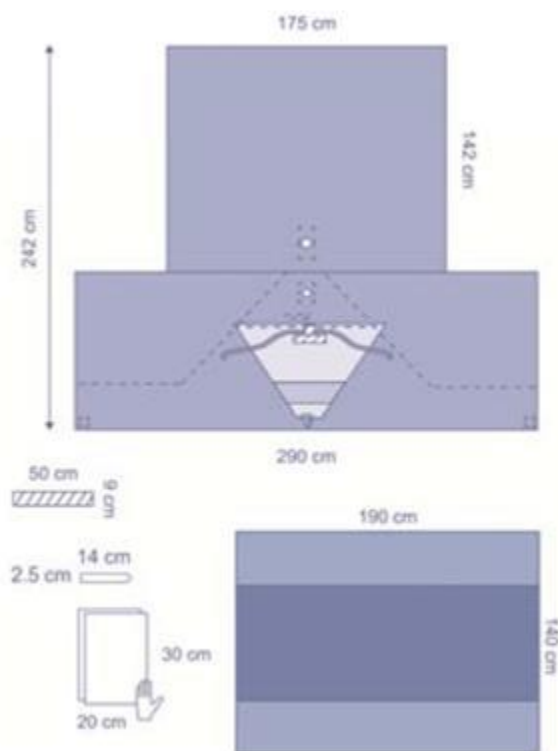

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 89

Pakiet 7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do chirurgii z decentralnym otworem. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, z folii PE 50 µm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej

1 x taśma przylepna, przeźroczysta 8 x 40 cm

1 x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20 x 30 cm

1 x serweta o wymiarach 220 x 240 cm +/- 1cm z decentralnym przylepnym otworem Φ 12 cm wykonana z chłonnego na całej powierzchni trójwarstwowego laminatu o gramaturze max. 66 g/m². pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log 10$). Laminat odporny na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O, wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 90

Pakiet 13

Poz.1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 30x28 , a całkowitej 28x38,5cm?

Poz.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 45x55cm , a powierzchni całkowitej 45x63,5cm?

Poz.3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 56x80cm , a powierzchni całkowitej 56x88,5cm?

Odpowiedź: Poz. 1, 2 i 3 - Tak.

Pytanie 91

Pakiet 14

Poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 34x40cm (całkowita 40x40cm)?

Poz.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 60x45cm (całkowita 70x45cm)?

Poz.3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 60x80cm (całkowita 70x80cm)?

Odpowiedź: Poz. 1, 2 i 3 – Tak, z uwzględnieniem wymogu folii jodowanej.

Pytanie 92

Pakiet 25 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na biodrze Skład zestawu:

1x Serweta na stół narzędziowy 140x190 cm, folia PE 50μ z polipropylenowym wzmocnieniem w części centralnej (owinięcie zestawu)

2x Serweta na stół narzędziowy 140x190 cm, folia PE 50μ, z polipropylenowym wzmocnieniem w części centralnej, złożona

1x Osłona na stół Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem Heavy Duty w części centralnej

5x Ręcznik chłonny 30x39 cm, biały

4x Fartuch chirurgiczny standardowy z włókny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty z tyłu zapinany na rzep o długości min. 17 cm, rozmiar XL 140 cm

2x Taśma lepna z białminatu 9x50 cm

1x Kieszeń na narzędzia 41x33 cm z przylepcem, jednokomorowa

2x Serweta lamarotomijna 60x60 cm 4W 20N wstępnie prana, biała z tasiemką, z nitką RTG, a'5

8x Kompres gazowy 10x10 cm 12W 17N z nitką RTG, a'10

1x Miska 500 ml, skalowana, niebieska

5x Kompres gazowy w kształcie kuli śr. 5cm, po rozłożeniu 23,5x64,5 cm z nitką RTG

1x Czyścik do końcówek elektrochirurgicznych z nitką RTG

1x Uchwyt do skalpeli, żółty z podziałem na 3, przylepiec od spodu

2x Bandaż elastyczny w rolce 500x15 cm

1x Strzykawka do irygacji trzyczęściowa 100 ml z podziałką co 2 ml, z zatyczką

1x Uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23 cm

1x Licznik igieł magnetyczno - piankowy, ze zdejmowaczem ostrzy, na 20 szt. (z nadrukiem numerycznym od 1 do 20szt.), 2 częściowy, zatrzaskowy zamek, krawędzie wieczek zachodzące na siebie, przylepiec na piance, taśma przylepna z symbolem BIOHAZARD do zabezpieczenia pudełka po użyciu, kolor żółty

1x Folia operacyjna 80x80 cm, powierzchnia lepna 70x80 cm

1x Zestaw do odsysania końcówka Yankauer Maxi Plus CH28, dren CH21 300 cm

1x Stokineta elastyczna 30x122 cm

1x Serweta 100x100 cm, bilaminat (PP+PE) 58 g/m², nieprzylepna

1x Serweta 150x150 cm, bilaminat (PP+PE) 58 g/m², nieprzylepna

1x Serweta górna 254x183 cm z przylepcem 98x254 cm, trilaminat max. 66 g/m²

1x Serweta 196x305cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, wykonana z chłonnego trilaminatu pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy - współczynnik pylenia ≤1,9 log10 o gramaturze max. 66 g/m² odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H₂O. Obszar krytyczny o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. I klasa palności.

Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta i kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 93

Pakiety 1 i 2:

Czy można zaoferować zestawy z taśmą samoprzylepną w rozmiarach 9cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 1 warstwy celulozy 23g oraz jednej warstwy folii 15g, wzmocniony 48 nićmi?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 95

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu podstawowego w którego składzie znajduje się serweta samoprzylepna w rozmiarze 200 x 200 cm zamiast serwety 175 x 200 cm? Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 96

Pakiet nr 5

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii dłoni/stopy w którego składzie znajduje się:- 1 szt. serweta operacyjna minimum 100 x 150 cm wykonana z grubej folii PE ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 97

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii ręki w którego składzie znajduje się serweta główna w kształcie litery T w rozmiarze 200/290 x 320 cm zamiast 250 x 350 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 98

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm (55 g/m²)
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem Ø10 cm (55g/m²)
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu:
- 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana)

Opakowanie typu sztywny blister posiadające min. jedną naklejkę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji z nr LOT, datą ważności oraz identyfikacją producenta.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 99

Pakiet nr 24

Pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy opisanym zestawie do kraniotomii nie doszło do omyłki pisarskiej:

- 1 x osłona na uchwyt do lampy zamiast uchwyt do lampy odp. TAK
- 1 x uchwyt do ssaka z metalową końcówką Fraz 150 ml zamiast 150 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił długość. końcówki ssącej jednorazowego użytku.

Pytanie 100

Pozycja 2 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy opisanym zestawie do operacji kręgosłupa nie doszło do omyłki pisarskiej:

- 1 x uchwyt do ssaka z metalową końcówką Fraz 150 ml zamiast 150 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił długość. końcówki ssącej jednorazowego użytku.

Pytanie 101

Pozycja 2 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego zmianę wymaganych ilości próbek dla zestawu w pozycji 2 tj.: 1 szt. zestawu sterylnego oraz 1 szt. zestawu niesterylnego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 102

Pakiet nr 26

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii ręki w którego składzie nie znajduje się 1 x strzykawka a 100 ml.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 103

Pozycja 1-3 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego zmianę wymaganych ilości próbek dla zestawów w pozycji 1, 2 i 3 tj.: 1 szt. zestawu sterylnego oraz 1 szt. zestawu niesterylnego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 104

PROJEKT UMOWY

§ 7 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 projektu umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej

Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 105

Pakiet nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania składowej zestawu w postaci serwety samoprzylepnej (z padem chłonnym w części krytycznej) wymaganej w rozmiarze 175x170-200cm, ale w rozmiarze 200x200cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 106

Pakiet nr 24, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej zestawu do neurochirurgii (kraniotomii), wykonanego z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni - dotyczy serwet okrywających pacjenta? Skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu);
1 x serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 145 cm;
2 x serweta 3-warstwowa, przylepna 50 x 50 cm;
1 x serweta Neuro 245x320cm, 3-warstwowa, otwór 30x19cm wypełniony folią, zintegrowany worek do zbiórki płynów;
4 x ręcznik celulozowy;
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm;
1 x uchwyt typu rzep;
2 x fartuch chirurgiczny standard XL;
1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm;
1 x uchwyt do ssaka typu Yankauer 24/8,00 Ch/mm;
1 x pojemnik plastikowy 500 ml;
1 x czyścik do koagulacji;
2 x strzykawka 20 ml Luer 2 częściowa;
4 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek;
1 x ostrze chirurgiczne nr 10;
1 x ostrze chirurgiczne nr 11;
1 x 2 szt. chusta z gazy z RTG 45 x 45 cm, po praniu wstępnym, 4 warstwy 20 nitek;
1 x uchwyt do lampy.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 107

Pakiet nr 24, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej zestawu do operacji kręgosłupa, wykonanego z materiału trójwarstwowego na całej powierzchni - dotyczy serwet okrywających pacjenta?

Skład zestawu:

1 x serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 145 cm;
1 x serweta 3-warstwowa, przylepna 175 x 170 cm;
1 x serweta 3-warstwowa, przylepna 240 x 150 cm;
2 x serweta 3-warstwowa, przylepna 90 x 75 cm;
2 x fartuch chirurgiczny standard XL;
4 x 10 szt. kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek;
1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 350 cm;
2 x strzykawka 20 ml Luer 2 części;
1 x uchwyt typu rzep;
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm;
4 x ręcznik celulozowy;
1 x ostrze chirurgiczne nr 10;
1 x ostrze chirurgiczne nr 11.

Odpowiedź: Nie.

Zamawiający równocześnie informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.12.2023 roku.

Nowy termin składania ofert do dnia 08.12.2023 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 08.12.2023 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ.